

Раздел «ГЛИКИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН»

Цикл 1-16


Номер лаборатории: 07812

Дата поступления результатов: 02.11.16


Назначенная дата: 08.11.16

 Определяемый показатель: **HbA1c**


ОЦЕНКА ПРАВИЛЬНОСТИ
Распределение средних значений

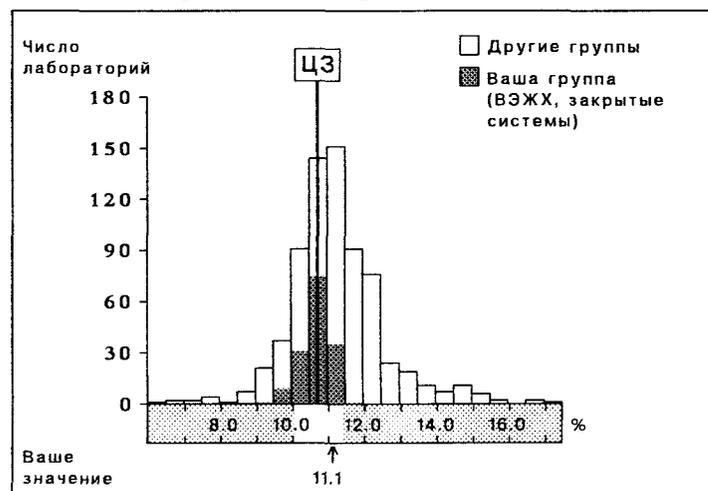

ОЦЕНКА ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ
Распределение междневных размахов

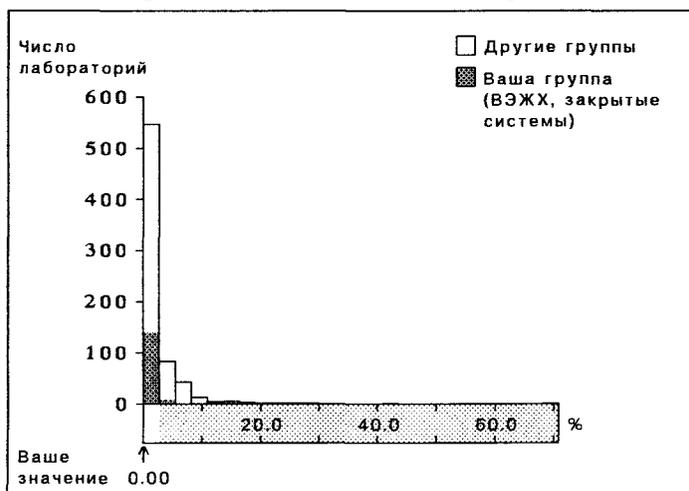

ОЦЕНКА ПОВТОРЯЕМОСТИ
Распределение внутривневных размахов

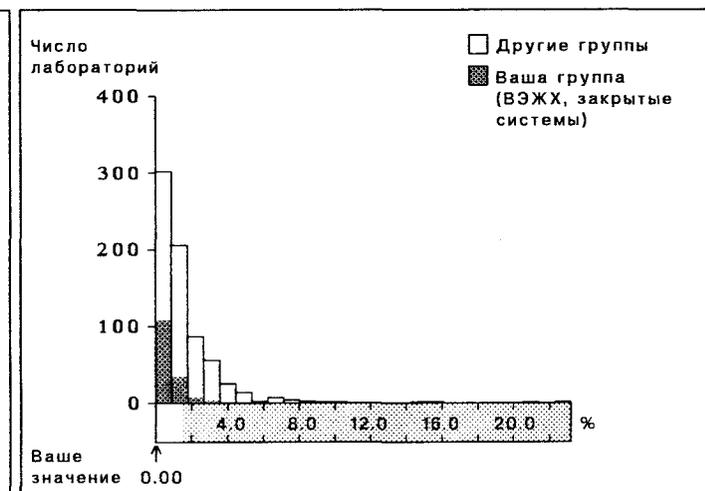

Ваше среднее значение, %	11.1	Ваш междневной размах, %	0.00
Целевое значение (ЦЗ), %	10.7	Допустимый междневной размах, %	2.64
Ваше смещение, %	+3.8	Средний междневной размах в Вашей группе, %	1.07
Диапазон допустимых значений (ЦЗ±1.64s)	10.0-11.4	Средний междневной размах всех лабораторий, %	2.32
Число лабораторий в Вашей группе	152	Число лабораторий при оценке воспроизводимости	152
Коэффициент межлабораторной вариации, %	3.89	Ваш средний внутривневной размах, %	0.00
Среднее всех лабораторий, %	11.3	Допустимый средний внутривневной размах, %	1.44
Число всех лабораторий	711	Средний внутривневной размах в Вашей группе, %	0.59
Коэффициент межлабораторной вариации, %	11.56	Средний внутривневной размах всех лабораторий, %	1.56
		Число лабораторий при оценке повторяемости	152

(конец отчета)